

UTi165A QA测试报告

环境温度：22.3℃/53.2%


一、检测项目：测温（精度2%取最大值）

二、检测设备（主要）：

黑体FLUKE4180、4181

三、测温表格：

设定温度（℃）	测试温度（℃）
-20	-18.5℃
0	0.5℃
30	31.2℃
60	60.8℃
90	91.2℃
120	119.7℃
140	139.6℃
180	178.9℃
250	248.9℃
300	297.8℃

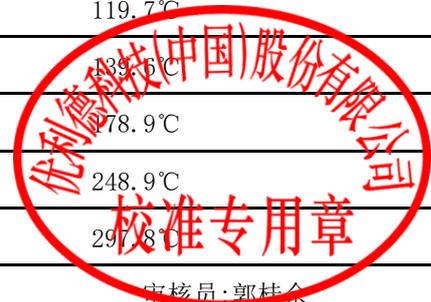

检查员：刘彩燕

审核员：郭桂余