


UTi80P QA测试报告

使用仪器器：FLUKE4180/FLUKE4181

环境温湿度：23.4℃ / 55%

功能	单位	黑体温度	最小值	最大值	测试距离cm	黑体型号	黑体发热面直径(cm)	ϵ	测试值	测试结果
温度测量	℃	-10.0	-12.0	-8.0	15	FLUKE4180	5.7	0.95	-9.8℃	合格
	℃	10.0	8.0	12.0	25	FLUKE4180	6.3		9.7℃	合格
	℃	20.0	18.0	22.0	25	FLUKE4180	6.3		19.8℃	合格
	℃	50.0	48.0	52.0	25	FLUKE4180	15.2		49.7℃	合格
	℃	100.0	98.0	102.0	25	FLUKE4181	15.2		98.6℃	合格
	℃	150.0	145.5	154.5	25	FLUKE4181	15.2		149.5℃	合格
	℃	200.0	194.0	206.0	25	FLUKE4181	15.2		198.8℃	合格
	℃	300.0	291.0	309.0	25	FLUKE4181	15.2		298.9℃	合格
	℃	400.0	388.0	412.0	25	FLUKE4181	15.2		398.8℃	合格

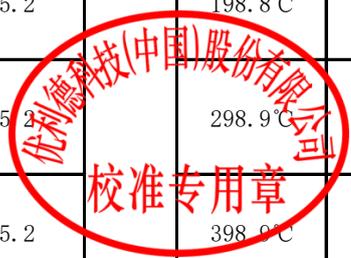

检查员：刘爱

审核员：郭桂余